




Local: CHAPECÓ - SC

Processo: ESTACIONÁRIO

Produto: 10005339 LOTE: 1627123

Detalhes da coleta de dados:

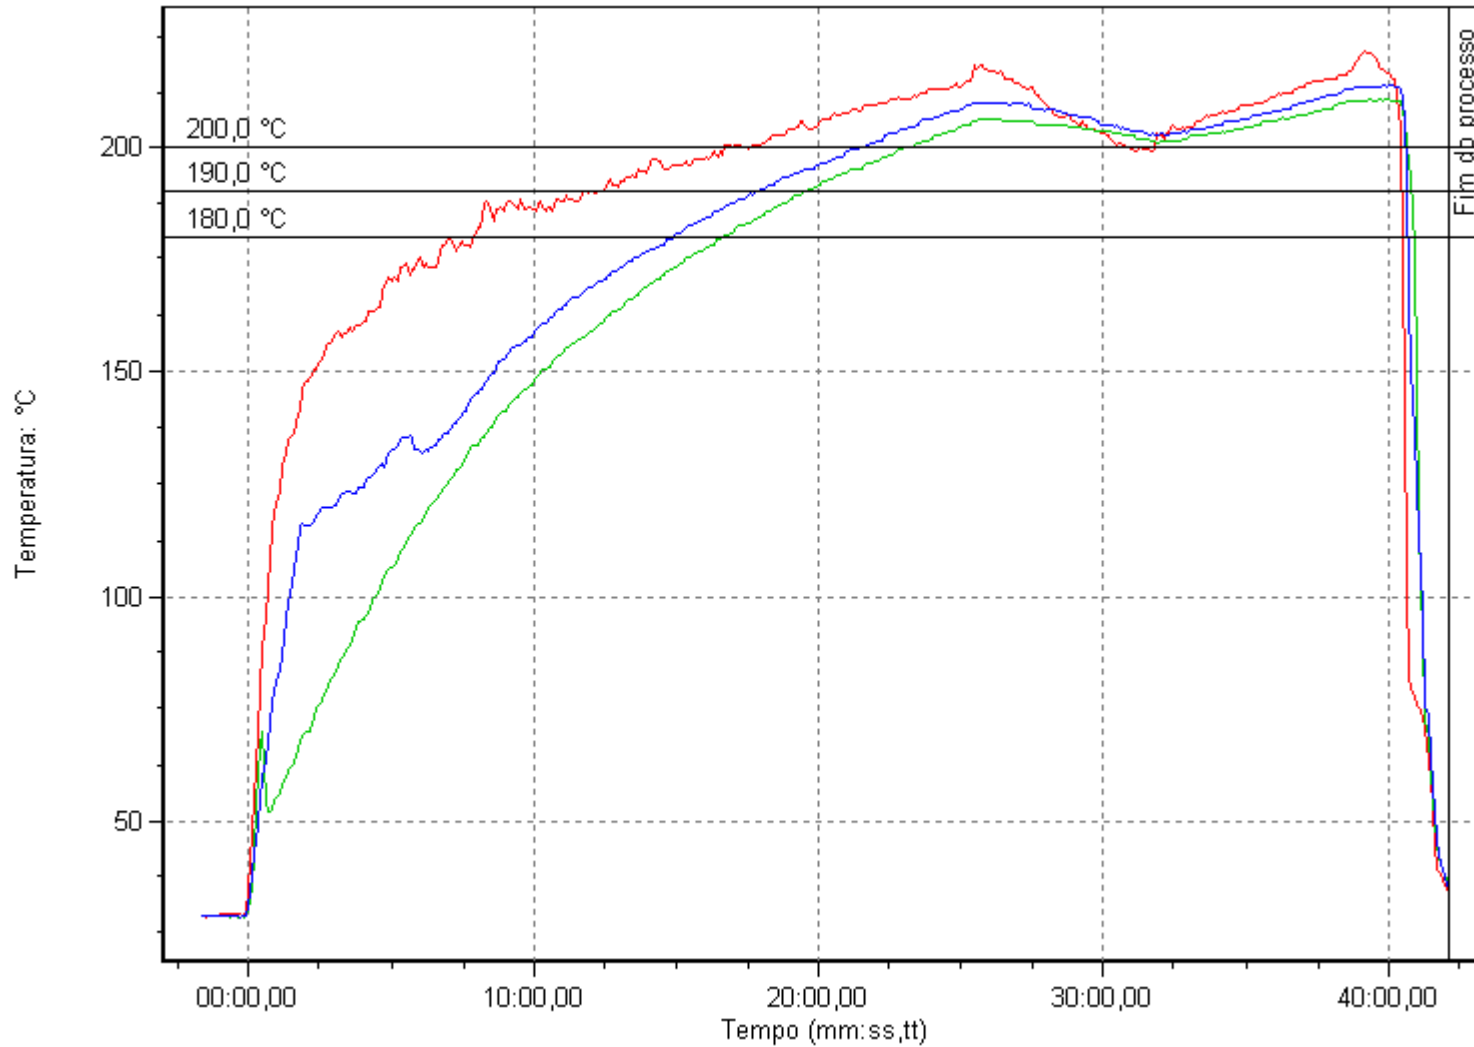

Criado por	Descarregar
Número de sondas	5
Intervalo de amostragem	0:05,00 (mm:ss,tt)
Dados carregados	13/03/2017 17:32:42
A coleta começou	13/03/2017 16:46:27
Temp. interna máx.	38,0 °C
Coletor	EasyTrack
ID do coletor	#7415
Operador	MÁRCIO MACENA
Hora impressa	13/03/2017 17:46:39

Notas:

TERMOGRAFIA DE ESTUFA CONTÍNUA
 PROGRAMAÇÃO: Q1: 200°C
 TEMPO REGRESSIVO: 1 CICLO = 13 MINUTOS
 RECOMENDAÇÃO: CURA DO PRODUTO ESPECIFICADO 10' A 200°C OU 15' A 190°C.
 RESULTADOS:
 DE ACORDO COM O RESULTADO DA TERMOGRAFIA A TINTA ESTÁ CURADA.
 OBS.: SEGUINDO OS PADRÕES DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE E MANTENDO A PROGRAMAÇÃO DA ESTUFA, PODEMOS AFIRMAR QUE NÃO OCORRERÁ DESPLACAMENTO DA TINTA.
 TERMOGRAFIA REALIZADA POR: WEG TINTAS

Sonda	Valor Datapaq					Máximo/Mínimo				Tempo na temperatura		
	Temp Min 180,0 Temp máx 220,0°C					Máximo (°C)	Máx. atingido (mm:ss,tt)	Mínimo (°C)	Mín. atingido (mm:ss,tt)	Tempo acima 180,0°C (mm:ss,tt)	Tempo acima 190,0°C (mm:ss,tt)	Tempo acima 200,0°C (mm:ss,tt)
	190,0°C 15:00,00 (mm:ss,tt)	200,0°C 10:00,00 (mm:ss,tt)	215,0°C 08:00,00 (mm:ss,tt)	Valor Datapaq								
#1 (°C) AR	28:25,00	22:50,00	04:00,00	335	221,5	39:15,00	28,5	-01:30,00	32:40,00	28:25,00	22:50,00	
#2 (°C) Esp. 2,65 mm	21:25,00	17:40,00	00:00,00	236	210,5	39:25,00	28,5	-00:40,00	24:15,00	21:25,00	17:40,00	
#3 (°C) Esp. 8,00mm	23:00,00	19:10,00	00:00,00	260	213,5	39:50,00	28,5	-00:20,00	25:50,00	23:00,00	19:10,00	